

甲钴胺含量

GLS-LC-0004

1. 实验分析

1.1 实验仪器及耗材

色谱柱: InertSustainSwift C18 5 μ m 250 $\times$ 4.6mm (PN:5020-88027)

GL Filter针式过滤器(GL0604 25mm $\times$ 0.22 μ m Nylon)

GL Vial样品瓶(GL0008 2mL透明瓶带刻度+GL0143红膜白胶垫片)

MPA-1200 电动移液枪

1.2 溶液配制

供试品溶液: 取本品10片, 必要时除去包衣, 分别置10mL容量瓶中, 加入流动相适量, 超声使甲钴胺溶解, 放冷, 用流动相稀释至刻度, 摇匀, 滤过, 取续滤液。

对照溶液: 取甲钴胺对照品, 称定, 加流动相溶解并定量稀释制成每1mL中约含50 μ g的溶液。

系统适用性溶液: 取甲钴胺对照品约5mg, 加入1mol/L盐酸溶液5.0mL, 避光放置1小时, 立即加入1mol/L氢氧化钠溶液5.0mL, 摇匀。

测定法: 量取供试品溶液和对照溶液, 分别注入液相色谱仪, 记录色谱图, 按外标法以峰面积计算每片的含量, 并计算10片的平均含量。

【系统适用性要求】

对照溶液色谱图中, 甲钴胺峰的保留时间约为13min, 甲钴胺峰与相对保留时间约为1.16的杂质峰之间的分离度应大于3.0。

色谱条件

色谱柱: InertSustainSwift C18 5 μ m 250 $\times$ 4.6mm (PN:5020-88027)

流动相: 0.03mol/L磷酸二氢钾溶液 (磷酸调PH值至4.5) -乙腈(82:18)

检测波长: 342nm

流速: 1mL/min

进样量: 20 μ L

柱压: 14.5MPa

技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司

地址: 上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话: 021-62782272

●技尔应用技术中心

地址: 上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话: 021-64260228

●技尔成都分公司

地址: 成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话: 028-85596177

●技尔广州办事处

地址: 广州市天河区天河北路233号

中信广场办公楼3217单元

电话: 400-089-1889



官网: www.glsciences.cn

服务热线: 400-089-1889

邮箱: contact@glsciences.com.cn


技尔(上海)官方网站 技尔(上海)官方微信公众号

仪器型号：岛津LC-16

检测器：UV


2. 实验结果与讨论

样品溶液图谱:

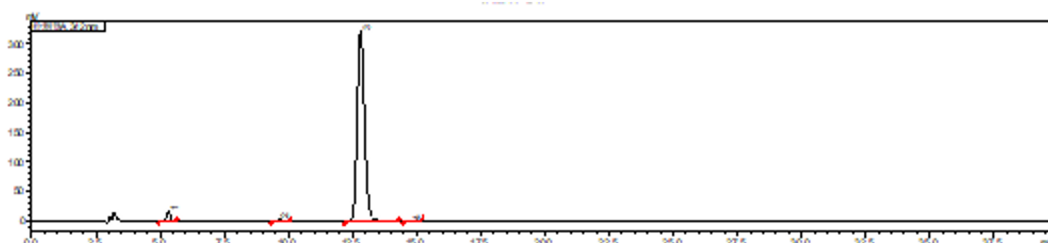


序号	名称	t/min	峰面积	峰高	理论塔板数	拖尾因子	分离度
1	甲钴胺	12.812	6333031	321193	9687	1.158	n.a.

对照图谱:

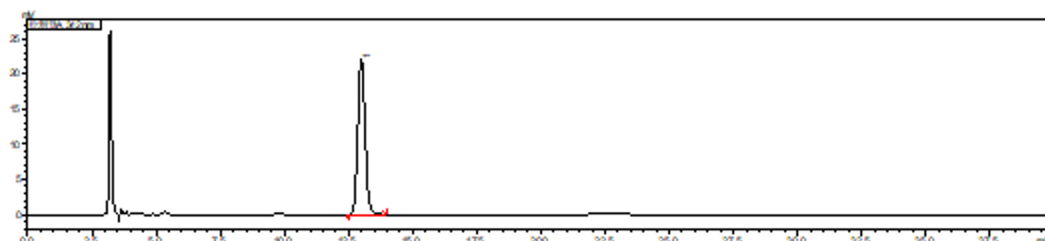

名称	t/min	峰面积	峰高	理论塔板数	拖尾因子	分离度
甲钴胺	12.995	432725	22044	10095	1.081	-

系统适用性:

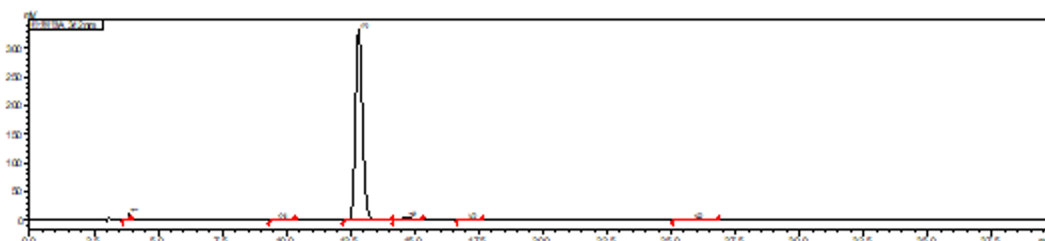

技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司

地址: 上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话: 021-62782272

●技尔应用技术中心

地址: 上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话: 021-64260228

●技尔成都分公司

地址: 成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话: 028-85596177

●技尔广州办事处

地址: 广州市天河区天河北路233号

中信广场办公楼3217单元

电话: 400-089-1889



官网: www.glsciences.cn


服务热线: 400-089-1889

邮箱: contact@glsciences.com.cn

技尔(上海)官方网站 技尔(上海)官方微信公众号

序号	名称	t/min	峰面积	峰高	理论塔板数	拖尾因子	分离度	相对保留时间
1	甲钴胺	12.817	6351701	332009	10235	1.149	n.a.	n.a.
2	杂质	14.697	137671	6480	10904	1.078	3.514	1.14

重复性:

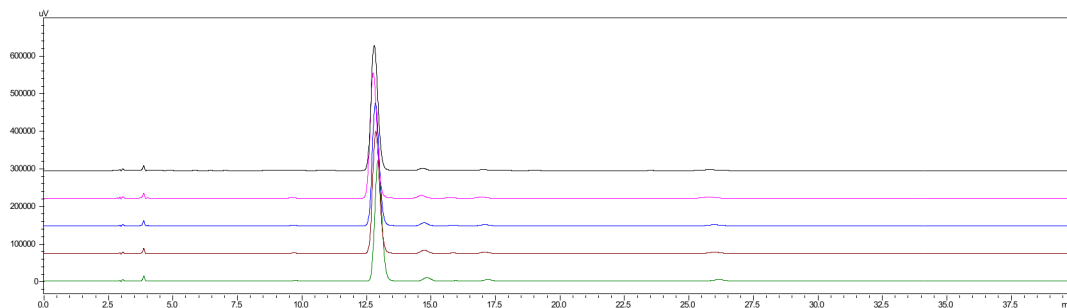

甲钴胺

进样针数	t/min	峰面积	峰高	理论塔板数	拖尾因子	分离度
1	12.817	6351701	332009	10235	1.149	n.a.
2	12.779	6309102	332762	10361	1.150	n.a.
3	12.864	6258624	326116	10274	1.148	n.a.
4	12.878	6210922	324312	10334	1.148	n.a.
5	12.964	6162029	320365	10325	1.148	n.a.

3. 结论

按照2020药典测试要求,使用InertSustain Swift C18 5 μ m 250 $\times$ 4.6mm (PN:5020-88027) 测试甲钴胺含量,甲钴胺峰与相对保留时间约为1.16的杂质峰之间的分离度满足大于3.0的要求。5次数据重复性良好,故InertSustain Swift C18 5 μ m 250 $\times$ 4.6mm (PN:5020-88027)适合用于2020版药典对甲钴胺含量的测定。

技尔(上海)商贸有限公司
GL Sciences (Shanghai) Ltd.

● 上海总公司

地址:上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话:021-62782272

● 技尔应用技术中心

地址:上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话:021-64260228

● 技尔成都分公司

地址:成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话:028-85596177

● 技尔广州办事处

地址:广州市天河区天河北路233号

中信广场办公楼3217单元

电话:400-089-1889



官网:www.glsciences.cn

服务热线:400-089-1889

邮箱:contact@glsciences.com.cn

技尔(上海)官方网站 技尔(上海)官方微信公众号